



Протокол измерений

2021.07.09 10-59-51

Оператор:

Организация:

Прибор: Твердомер Т-УДЗ 009.267.1120 / 1048969346

Ультразвуковой датчик 1045240420

09.07.2021 11:06

Замеры





Протокол измерений

2021.07.09 10-59-51

Оператор:


Организация:

Прибор: Твердомер Т-УДЗ 009.267.1120 / 1048969346


Ультразвуковой датчик 1045240420

09.07.2021 11:06

Серия измерений #1

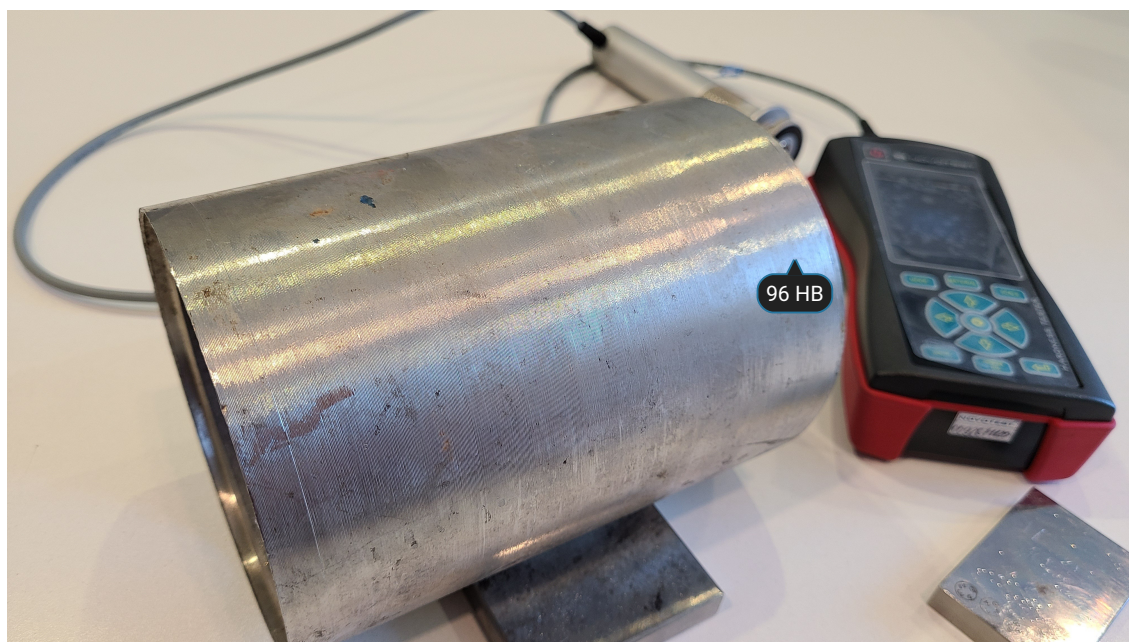

Параметр	Значение
Максимум	99
Минимум	94
Среднее	96
Количество	5

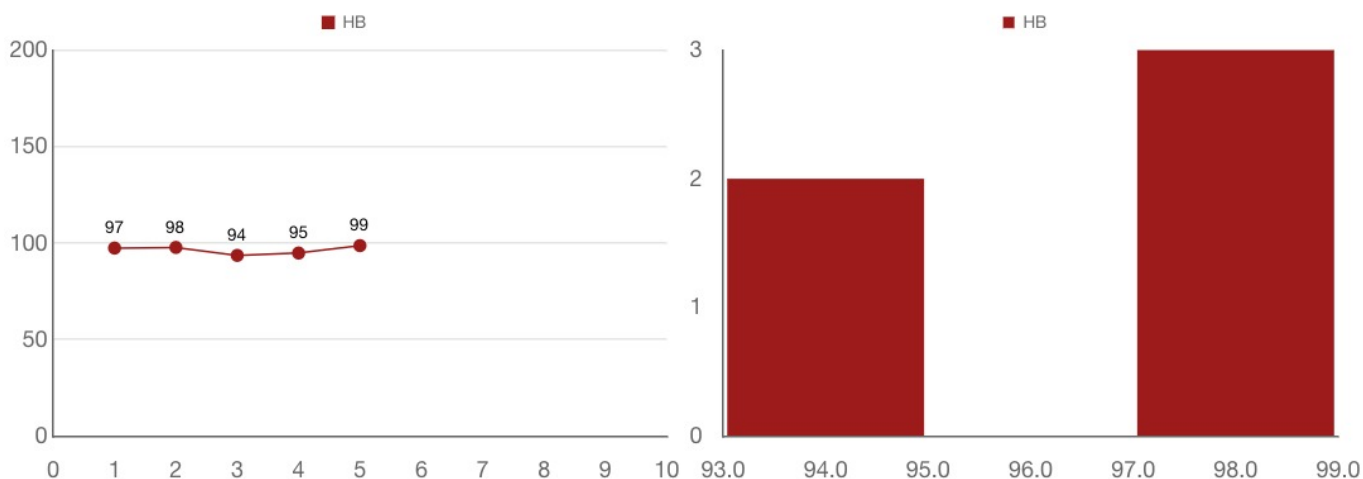



Протокол измерений

2021.07.09 10-59-51

Оператор:

Организация:

Прибор: Твердомер Т-УДЗ 009.267.1120 / 1048969346


Ультразвуковой датчик 1045240420

09.07.2021 11:06

Серия измерений #2



Параметр	Значение
Максимум	106
Минимум	102
Среднее	103
Количество	5

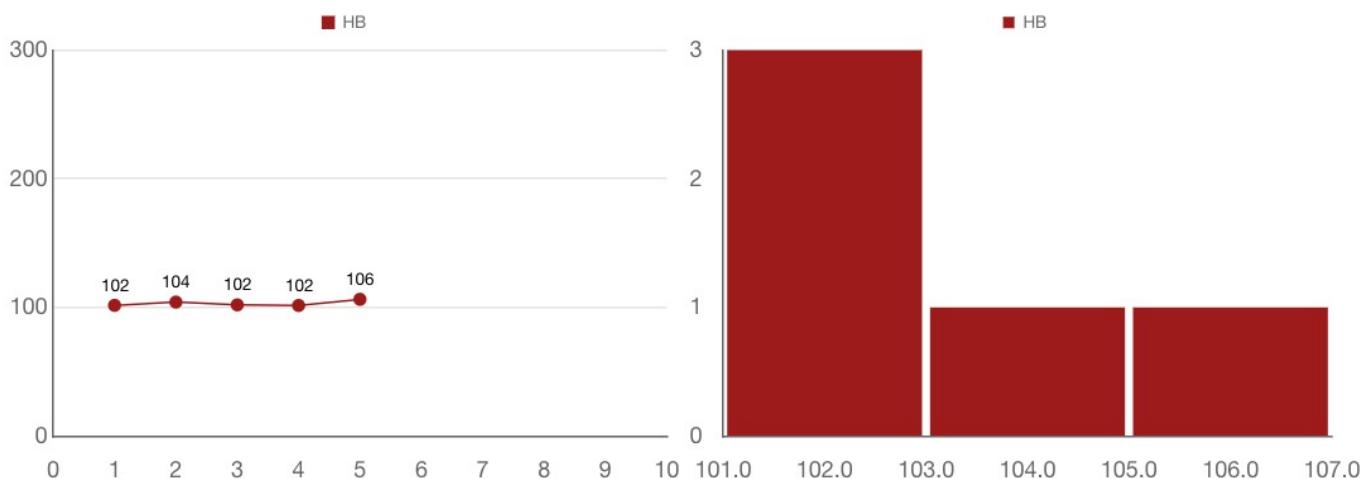



Протокол измерений

2021.07.09 10-59-51

Оператор:


Организация:

Прибор: Твердомер Т-УДЗ 009.267.1120 / 1048969346


Ультразвуковой датчик 1045240420

09.07.2021 11:06

Серия измерений #3

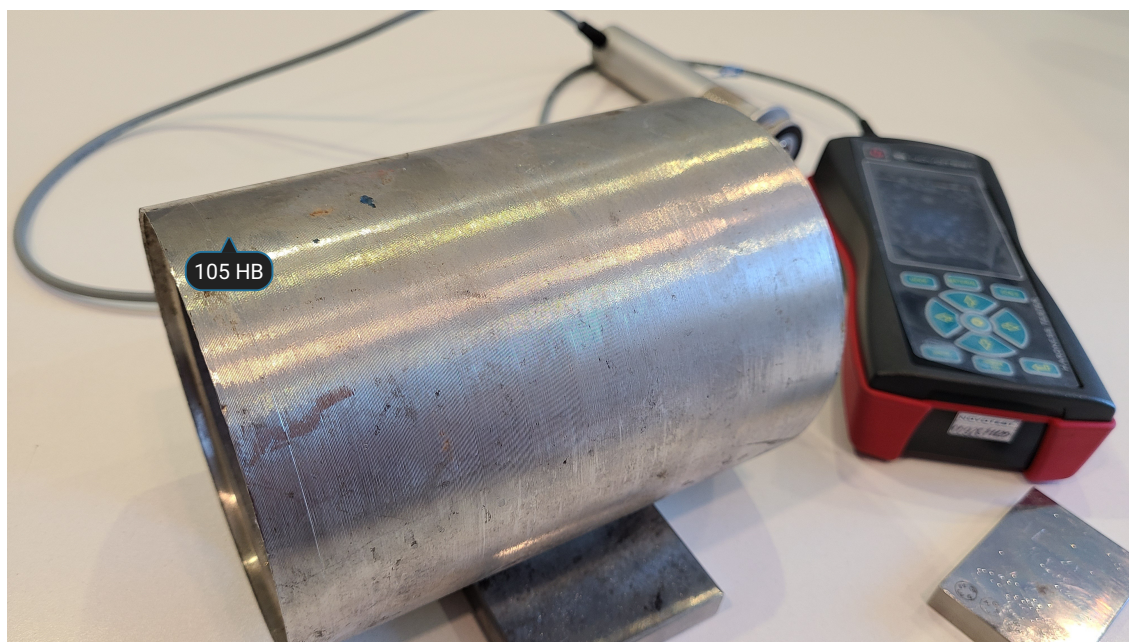

Параметр	Значение
Максимум	108
Минимум	103
Среднее	105
Количество	5

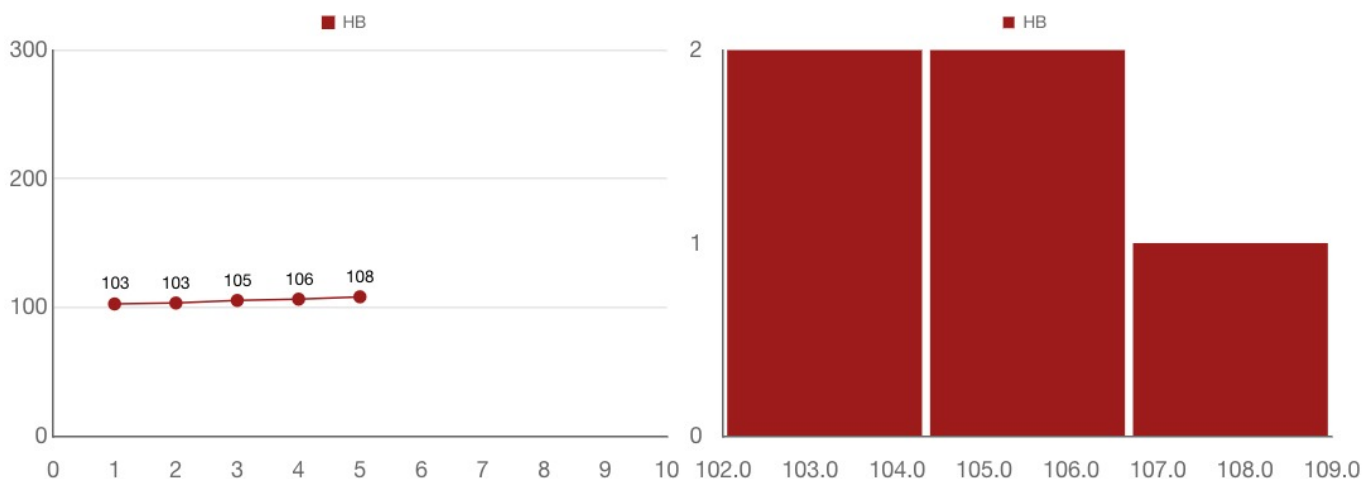



Протокол измерений

2021.07.09 10-59-51

Оператор:

Организация:


Прибор: Твердомер Т-УДЗ 009.267.1120 / 1048969346

Ультразвуковой датчик 1045240420

09.07.2021 11:06

Геолокация

Координаты места, в котором производились измерения: 48.63323 35.21578

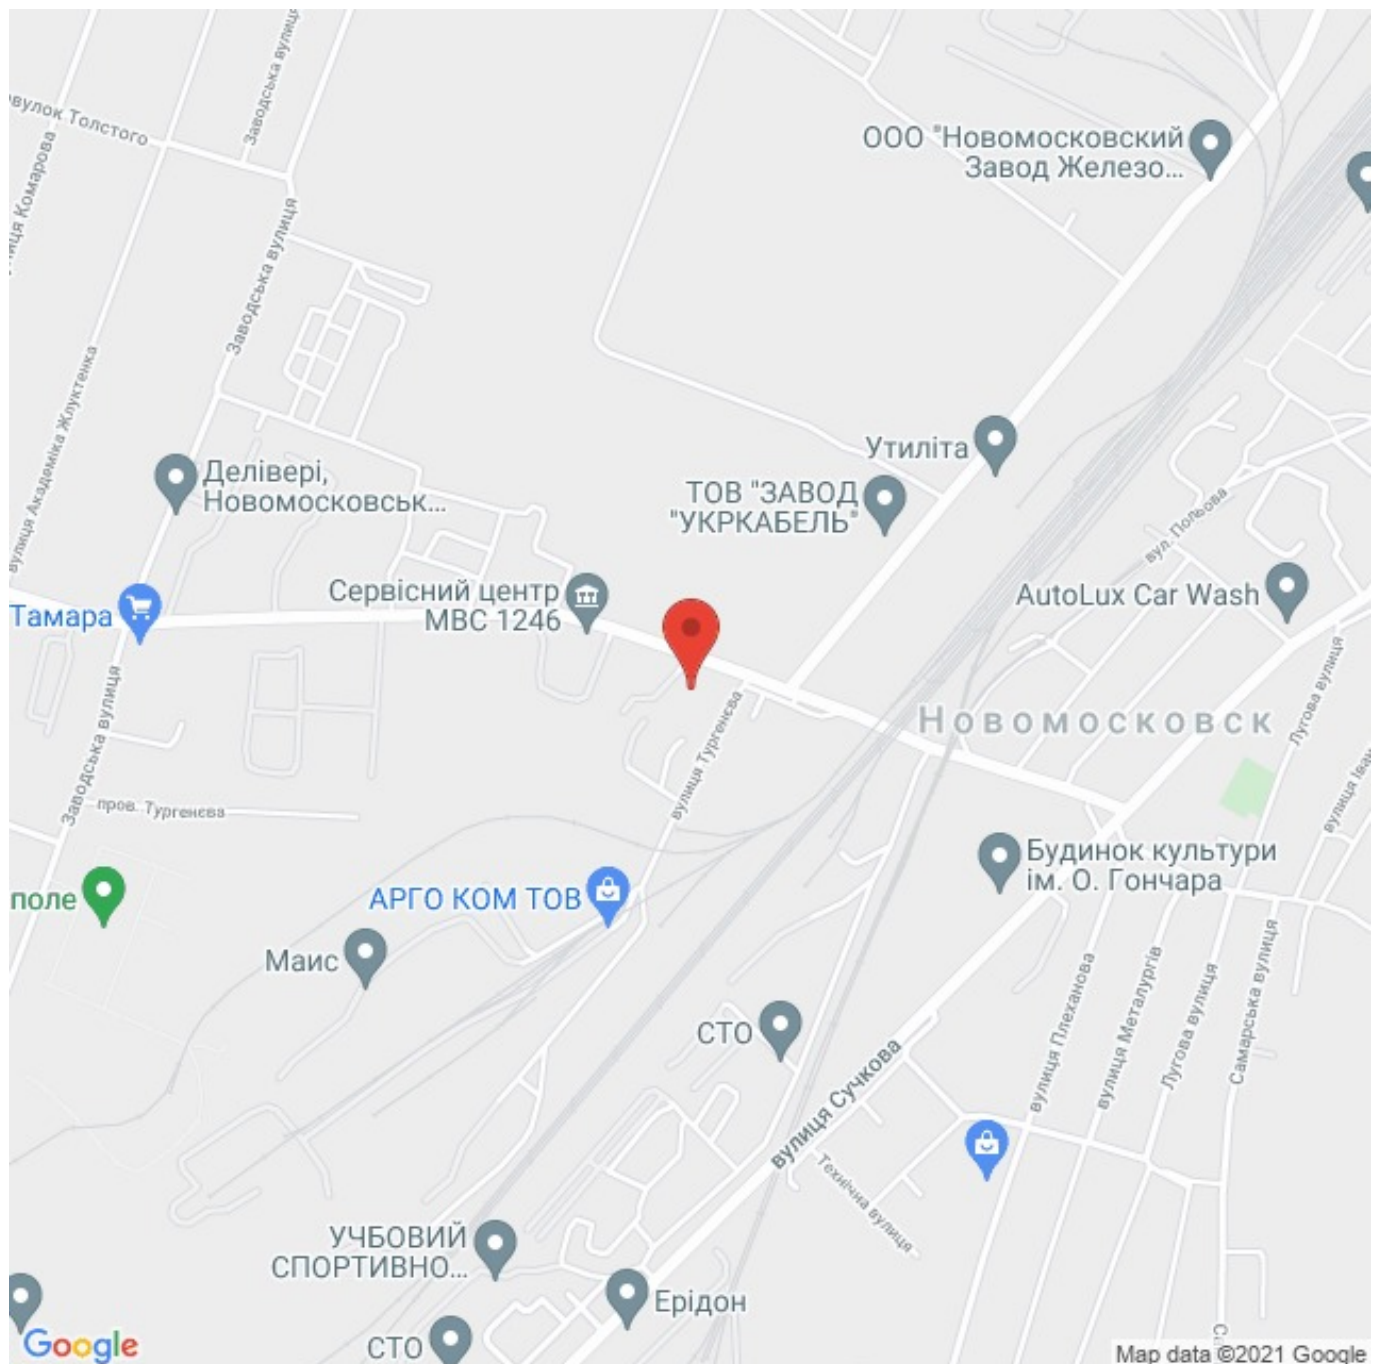



Протокол измерений

2021.07.09 10-59-51

Оператор:

Организация:

Прибор: Твердомер Т-УДЗ 009.267.1120 / 1048969346

Ультразвуковой датчик 1045240420

09.07.2021 11:06

Заметки

Образец труба ф115

Дополнительные файлы

Аудио записи

2021.07.09 11-05-04.waw

Видео записи

2021.07.09 11-04-47.mp4

Аудио и видео записи доступны по адресу <https://archive.novotest.biz/NgNQKhu58rW1h38A9>
Вы можете перейти по этому адресу отсканировав QR код вверху станции

Оператор

Подпись